


О метрологической аттестации установки для определения величины деформации материалов

Циклические испытания текстильных и кожевенных материалов, имитирующие процесс носки обуви и одежды, применяются при количественном определении показателя качества «циклическая формоустойчивость» на этапе выбора материала. В статье рассматривается новая методика метрологической аттестации установки для измерения величины деформации материалов после циклических нагружений



А.Н. Махонь

доцент кафедры стандартизации Витебского государственного технологического университета, г. Витебск, Республика Беларусь, anmakhon@mail.ru, канд. техн. наук

К.С. Матвеев

директор республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета», г. Витебск, Республика Беларусь

ри проведении исследований формоустойчивости листовых анизотропных материалов (тканей, трикотажа, кож и др.) в условиях, близких к эксплуатационным, возникает необходимость контроля геометрических параметров элементарных проб. Это означает, что необходимо выполнить измерение физической величины с обоснованной точностью результата измерений. Применение для этих целей механических средств измерений, в частности штангенциркуля, связано с большой трудоемкостью операций, высокой погрешностью и субъективностью.

Предложенная нами методика метрологической аттестации измерительной установки (ИУ) позволяет, на наш взгляд, обеспечить объективность выполнения измерений, обосновать их соответствие метрологическим требованиям и характеристикам.

Суть методики в следующем.

Определение осевых остаточных деформаций листовых анизотропных материалов, применяемых в производстве изделий легкой промышленности, проводится визуально-оптическим методом. Визуально-оптический метод относится к оптическому неразрушающему контролю, основанному на взаимодействии оптического излучения с объектом изучения [1], поэтому позволяет избежать погрешности, которую вызывает деформируемость материалов при использовании механических средств измерений.

Известно, что измерительная установка — это «совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенных для измерения ... физических величин, расположенная в одном месте» [2]. В нашем случае

в ИУ в качестве приемного устройства применяется сканер, регистрирующий первичный информативный параметр после его взаимодействия с объектом контроля, программное средство (функция осуществления измерений геометрических параметров чертежно-графического редактора системы трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D), служащее измерительным преобразователем, и персональный компьютер (ПЭВМ) с соответствующим программным обеспечением.

Чтобы обосновать возможность использования совокупности указанных устройств для измерения осевых остаточных деформаций, было проведено их исследование на соответствие метрологическим требованиям, предъявляемым к ИУ, которое позволило сделать следующие выводы.

Сканер как прибор оптического неразрушающего контроля может быть использован в данном процессе, поскольку он согласно стандарту ГОСТ 24521–80 «Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения» [1] представляет собой оптическую систему, состоящую из осветительных, оптических и регистрирующих устройств. В соответствии с требованиями стандарта СТБ П 8021–2003 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрология. Основные термины и определения» [2] измерительным преобразователем может быть признано «техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований,

ключевые слова

листовые анизотропные материалы, циклическая формоустойчивость, осевые остаточные деформации, визуально-оптический метод, измерительная установка, погрешность измерений

справка

Анизотропия — зависимость физических свойств вещества (механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических) от направления (в противоположность изотропии — независимости свойств от направления). Искусственная оптическая анизотропия возникает в кристаллах и изотропных средах под действием электрического и магнитного полей, а также механического воздействия. Комбинируя стеклянное волокно с пластмассами, удается получить анизотропный листовый материал с прочностью на разрыв до 100 кгс/мм². Искусственную анизотропию можно также получить, создавая заданное распределение механических напряжений в первоначально изотропном материале. Например, при закалке стекла можно получить в нем анизотропию, которая влечет за собой упрочнение стекла

индикации или передачи». Чертежно-графический редактор КОМПАС-3D является именно таким средством, так как позволяет проектировать объекты с заданными параметрами в установленном масштабе с необходимой точностью линейных измерений в установленных единицах.

Следовательно, установка, объединяющая сканер, персональный компьютер и программное средство, отвечает определению измерительного устройства, приведенному в [2]. Однако для обоснования точности линейных измерений необходимо доказать, что измерительное устройство способно обеспечивать нормированные метрологические характеристики. Эту задачу можно решить с помощью метрологической аттестации измерительной установки.

При проведении метрологической аттестации нужно установить, что действительные значения измеряемой величины соответствуют значениям сканированного и измеренного изображения величины, в противном

случае требуется оценка погрешности средства измерения (СИ). При определении величины осевых деформаций после циклических нагружений используется метод непосредственной оценки [2], то есть значение искомой величины определяется по показывающему СИ. В данном случае им являлся модуль выполнения графических измерений, включенный в интерфейс графического редактора системы КОМПАС-3D.

При проведении метрологической аттестации использовался метод сравнения с мерой. В качестве меры выступала многозначная штриховая мера длины (линейная шкала), нанесенная на стекло лупы монокулярной, цена деления которой составляет 0,1 миллиметра. Обеспечение подобной точности является достаточным для выполнения измерений листовых анизотропных материалов текстильных и кожевенных изделий.

Метрологическая аттестация измерительного устройства проводилась поэтапно.

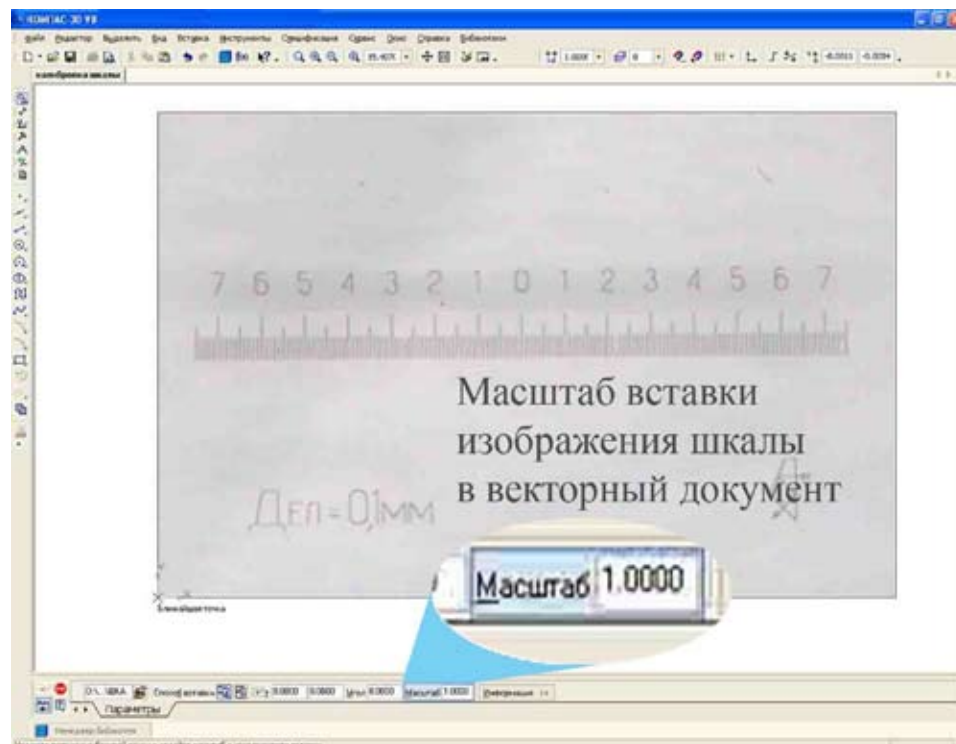


Рис. 1. Вставка растрового объекта в графический векторный документ